□□□□□□□□ 1064 1320 755 532 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ Q Switch Nd YAG

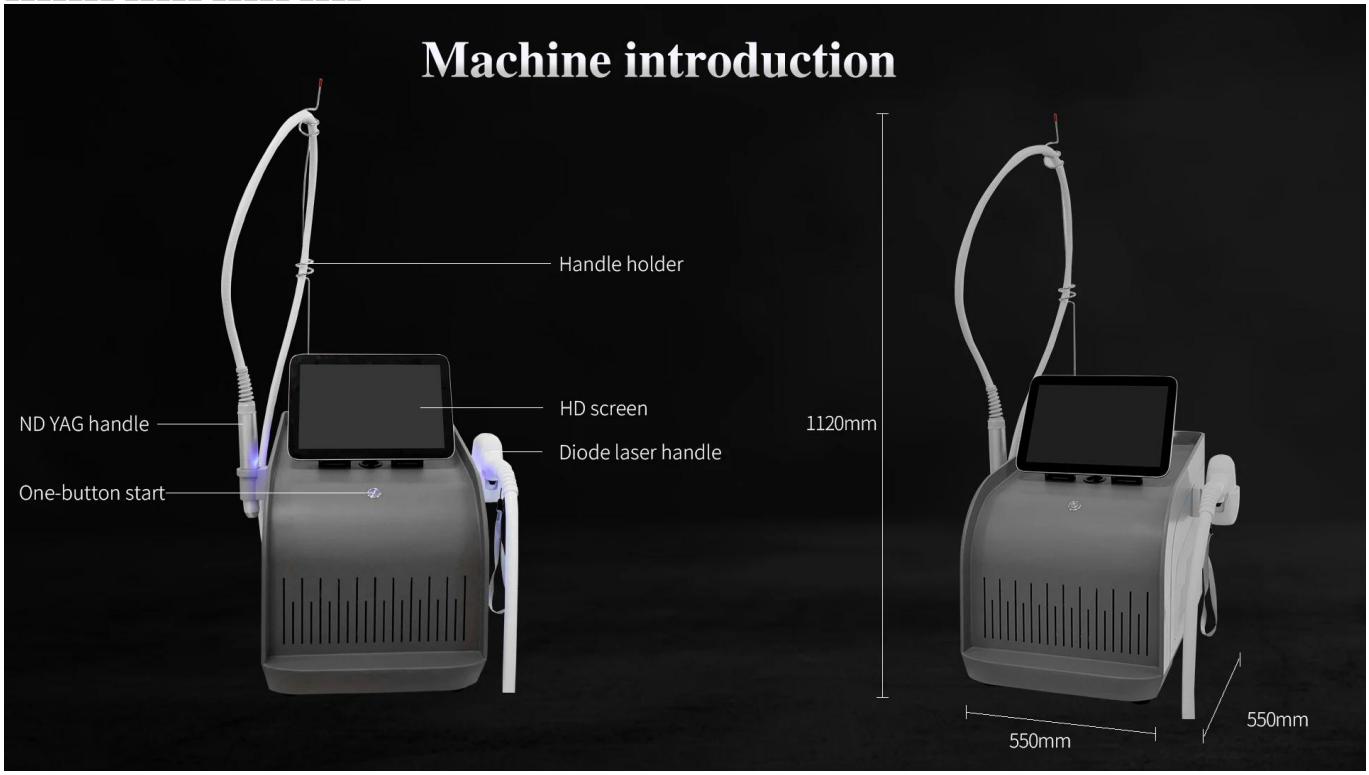

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ .1 □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ .4 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ .3 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .2 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

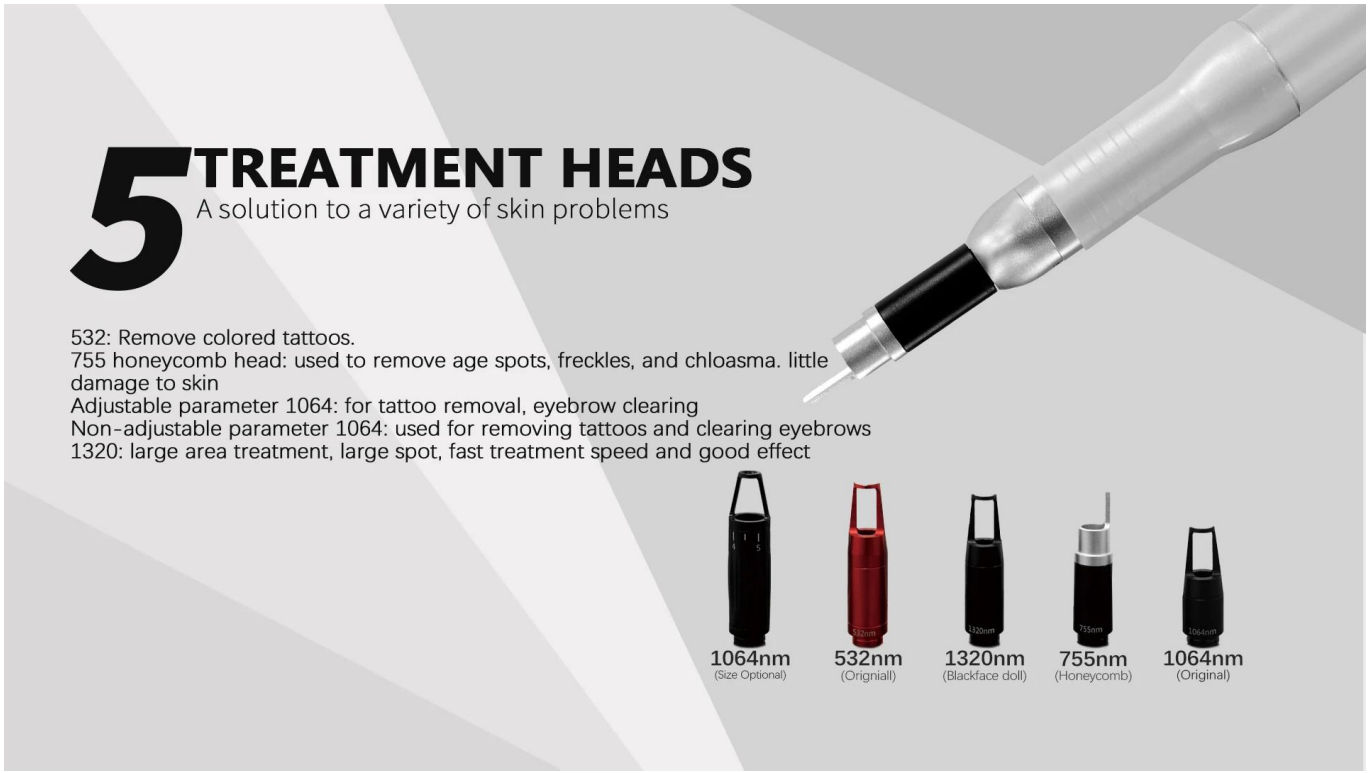

□□□ □□□□□ □□□□□□ .2 .□□□□ □□□□□ □□□ .□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ .1 □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ .3 .□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

5 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□

1. 532: □□□□□□ □□□□□ □□□□□.
2. □□□□□ □□□ □□□□ □□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :755 □□□□□ □□□□ □□□
3. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ :1064 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□
4. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :1064 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□
5. 1320: □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

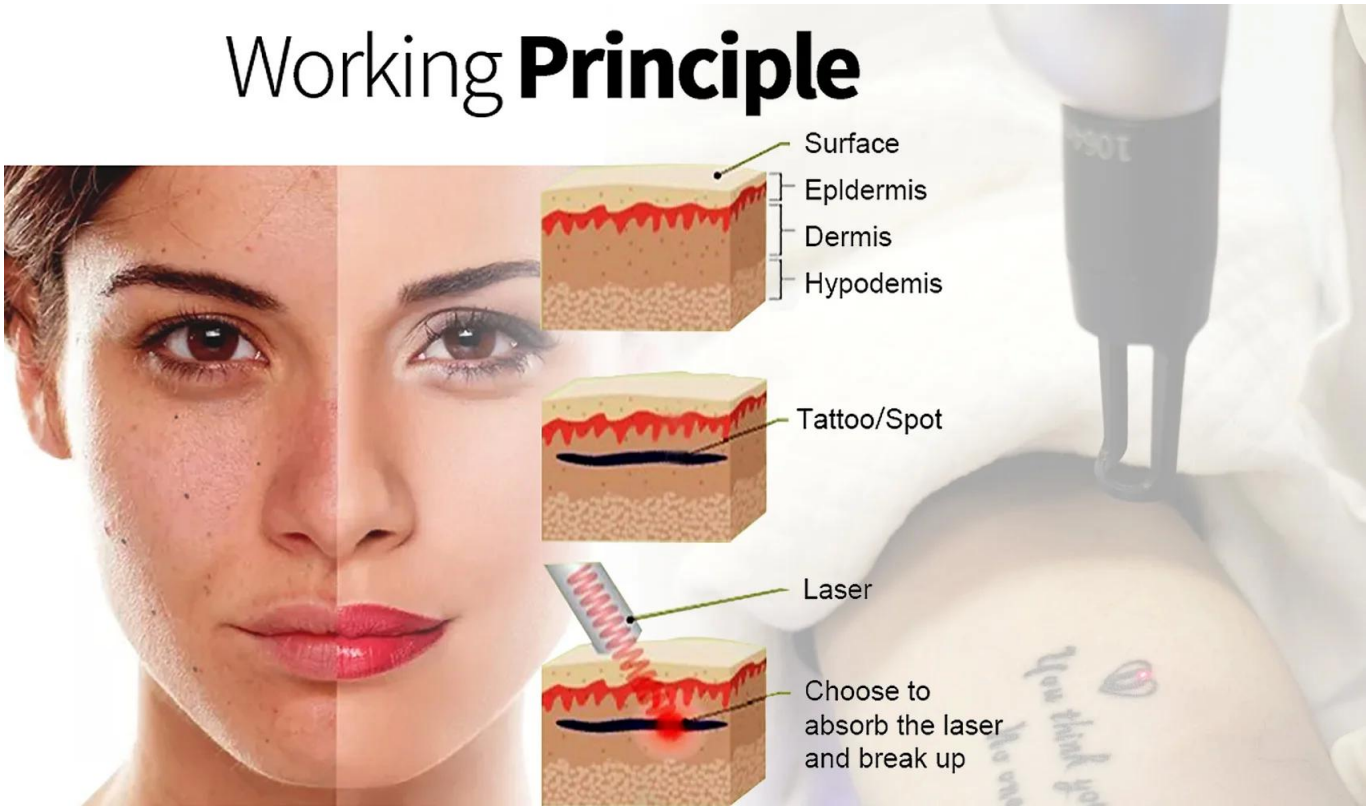

□□□□□ □□□□□ □□□□ Q-switch □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ Q-switch.
□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□.
□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□.

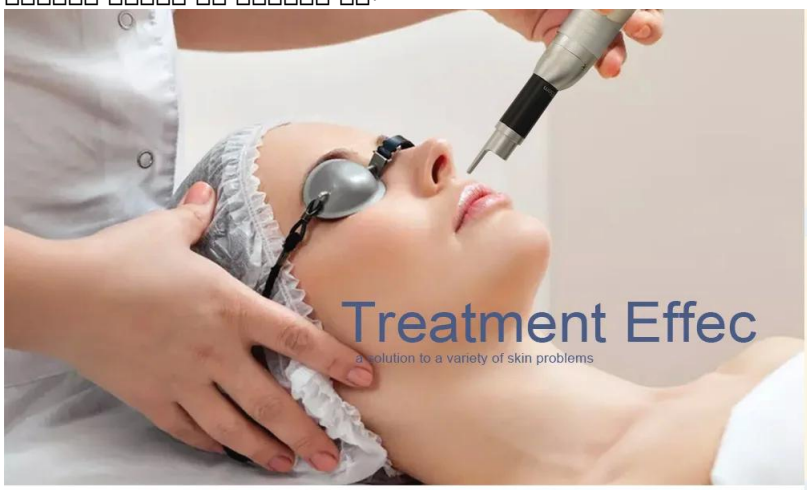

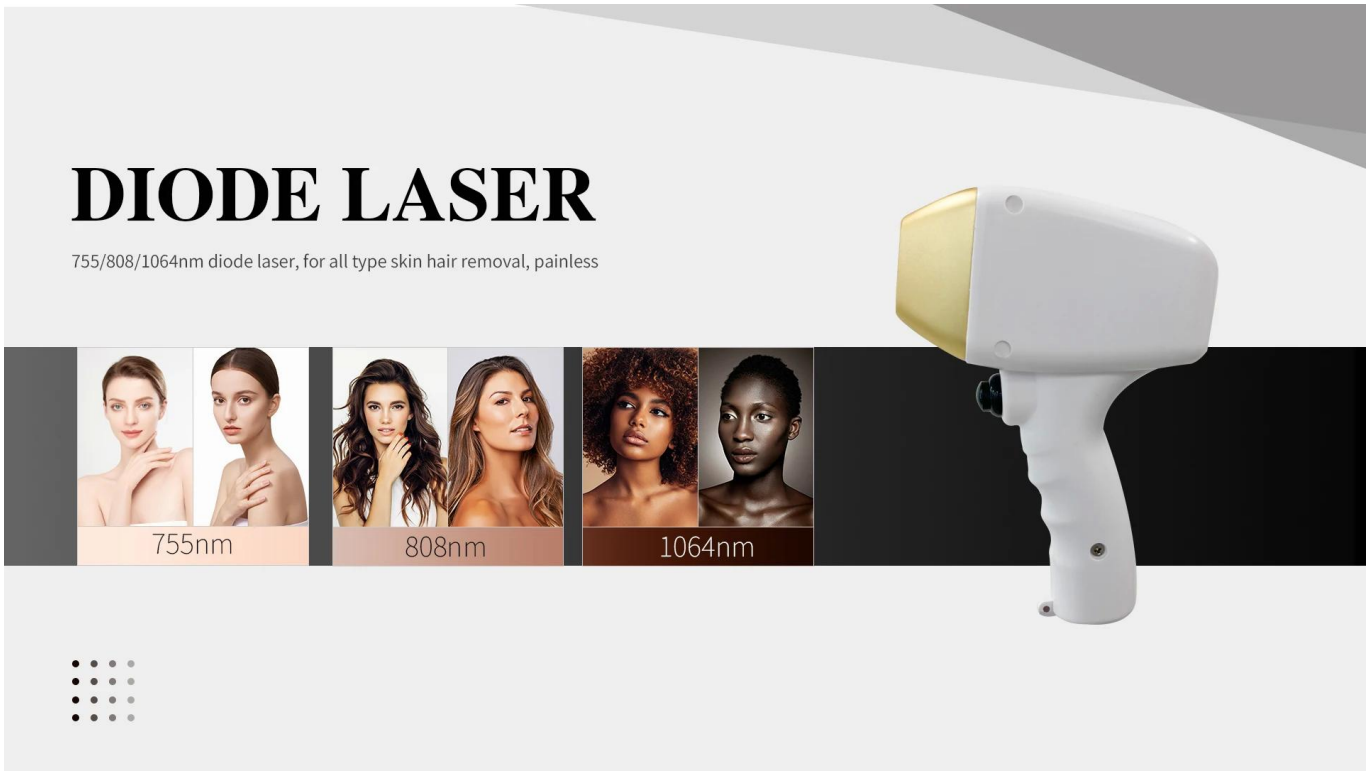

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ nd yag 2 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ 1 □□
.□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ *
.□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ 3 □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ 50 □□ □□□□ *
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ 1 □□ 3 □□□□□□□□ 755 □□□□□□□ 808 □□□□□□□ 1064 □□□□□ 3 *

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ 755 □□□□□.1
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ 808 □□□□□□ □□□□□ □□□□ .2
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ 1064 □□□□ □□□ .3

CLINICAL EFFECT
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

□□□□□□□ □□□

□□□□ 12.1 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

6 □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□

□□□□ □□□□ □□□ OEM□ □□□□□/□□□□/□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□

A
755/808/1064nm diode laser hair removal
B
Picosecond Laser
Multi-light
Dual Handles in One System
Work simultaneously or independently
faster treatment for more profits

*!□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ 24*7!*